

Google Fit ご利用手順


注意

- 歩数送信/歩数同期済みの場合、当日中のGoogle Fitへのデバイス(歩数測定機器変更)はできません。
翌日0:00以降、Google Fitへデバイス(歩数測定機器変更)ができます。
- Google Fitへのデバイス(歩数測定機器)変更は1日1回です。

Google Fit 健康マイレージ

健康マイレージのアプリで Google Fit を利用する場合、下記の手順のとおり、設定を行ってください。
歩数送信を行うと、当日中は測定デバイスの変更ができません。また未送信分の歩数は破棄されますので、
1日の初めに測定デバイスの変更を実施することを推奨します。

1 設定を選択する

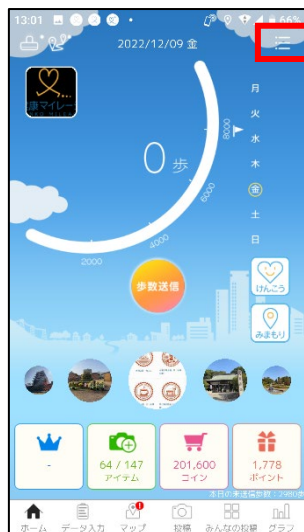


アプリホーム画面右上の
メニュー画面を選択します。

2



メニュー一覧が表示されます
ので[設定]を選択します。

3

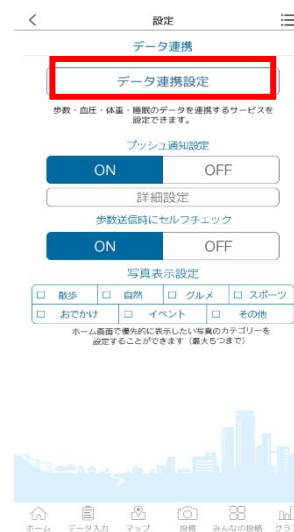

[設定]情報が表示されます
ので[データ連携設定]を選択
します。

4



[歩数]を選択します。

5



[Google Fit (スマートフォン)]
を選択します。

6



未送信の歩数がある場合、
破棄されてしまうのでご注意ください。
注意をお読みいただき問題なければ
[OK]を選択します。

Google Fitのインストール
をされていない方こちら

7

Google Fitのインストール
済みの方はこちら

9

7



「OK」を選び
[google ストア]へ移動します。

8




[インストール]をタップし、インストールが完了後「開く」を選択します。
アプリを開き利用するアカウントを選択後、基本情報の設定を行います。
(スキップせずに項目の入力をお願いいたします。)

[google ストア]にて [Google Fit]をインストールします。

Google Fit 健康マイレージ

9

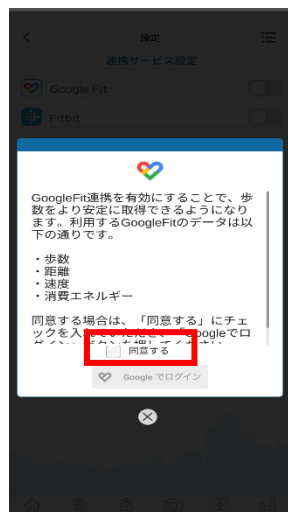


[同意する]にチェックを入れ、その下の[Googleでログイン]を選択します。

10




ご利用のアカウントを選択します。

11

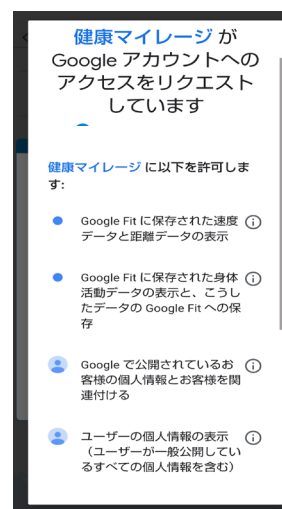

下までお読みいただき、[許可]を選択してください。

12

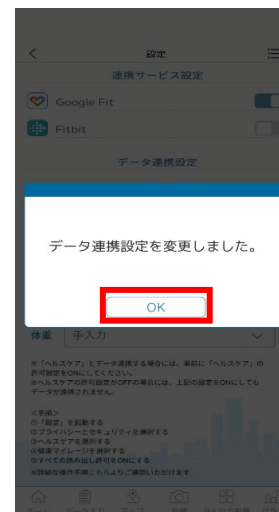

計測デバイス変更完了の旨が表示されますので[OK]を選択します。

13



歩数の測定デバイスが[Google Fit (スマートフォン)]に表示され、設定は完了です。